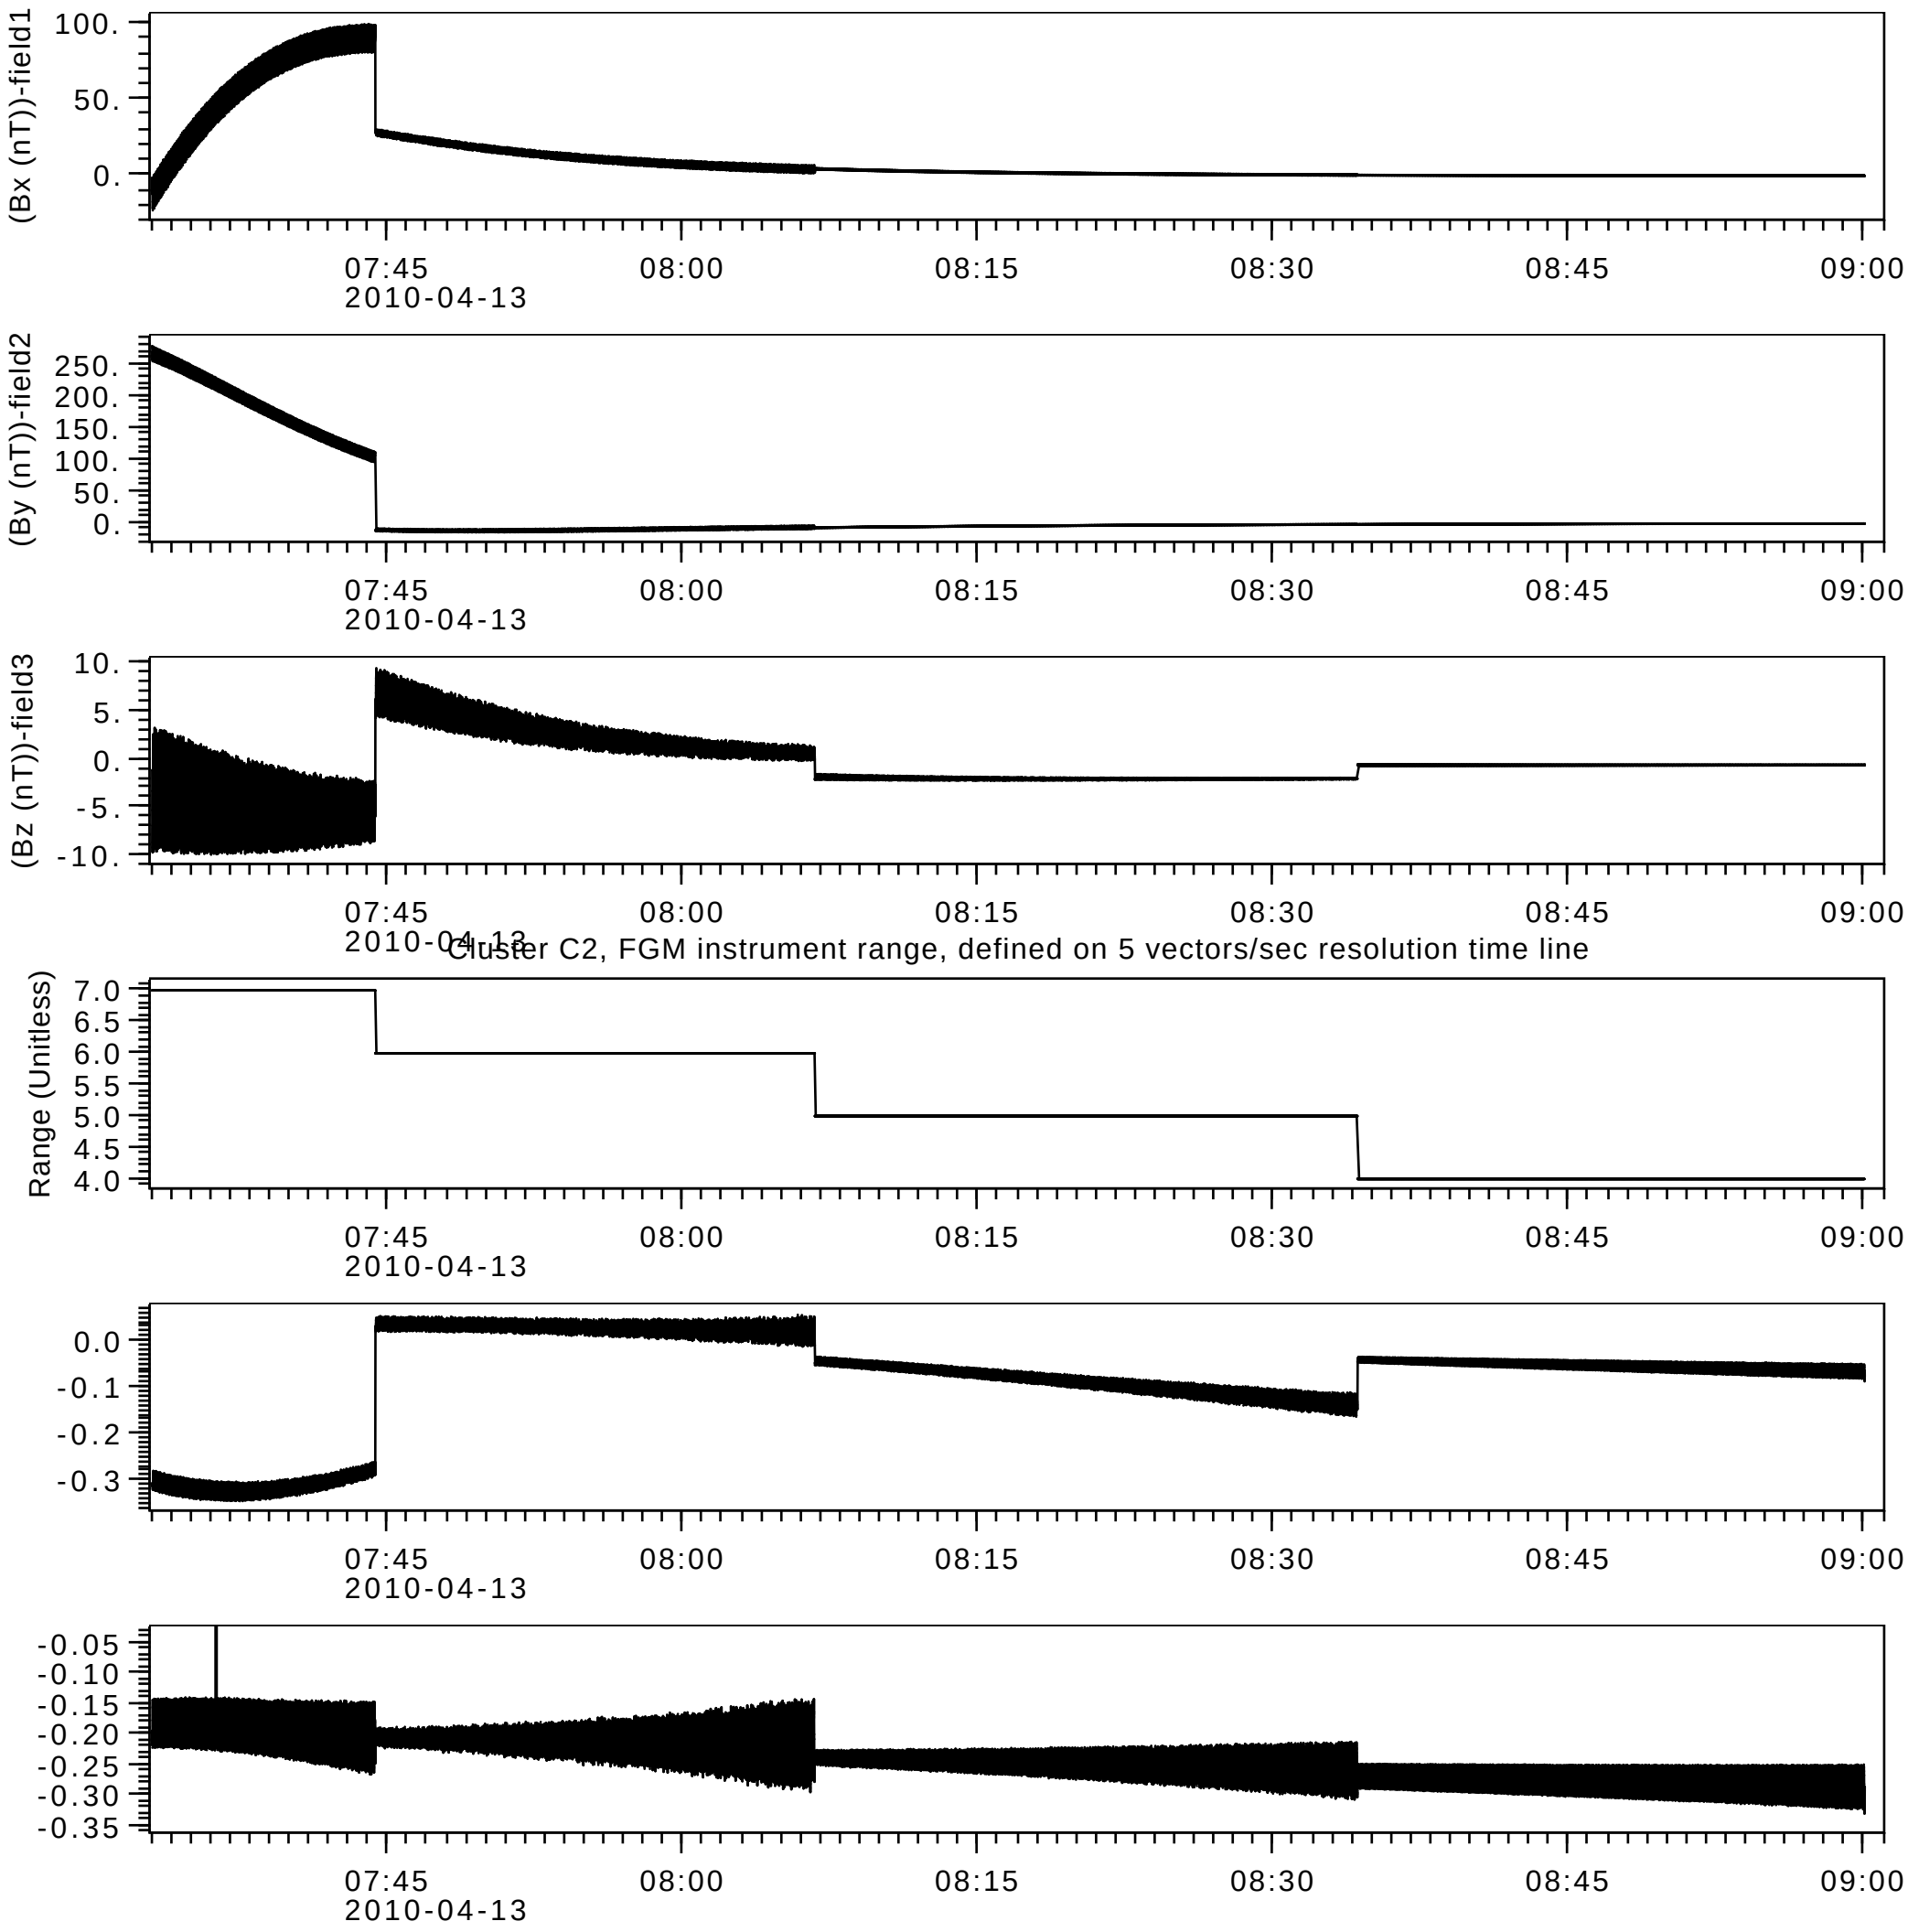
(Bx (nT))-field1
100.
50.
0.
07:45
2010-04-13
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
(By (nT))-field2
250.
200.
150.
100.
50.
0.
(Bz (nT))-field3
10.
5.
0.
-5.
-10.
Cluster C2, FGM instrument range, defined on 5 vectors/sec resolution time line
Range (Unitless)
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
0.0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-0.30
-0.35